FR-V0726

Utilisation sécurisée du lève-personne sur rail

PROTOCOLE D'UTILISATION

Modèle :
FIX-S
Poids maximal :
200 kg (!)

USAGE SANITAIRE / BATTERIE RECHARGEABLE / SÉCURITÉ OBLIGATOIRE / MAINTENANCE PÉRIODIQUE

1 VÉRIFICATIONS AVANT CHAQUE UTILISATION

- Vérifier visuellement l'état de la sangle du lève-personne, du cintre de levage et des sangles du harnais.
- Vérifier visuellement les fins de course et l'état du rail.
- Consulter le document d'évaluation des risques du patient (y compris la sélection du harnais et de sa taille).
- Suivre les instructions du lève-personne et du harnais.
- Vérifier la libre circulation du lève-personne sur l'ensemble du parcours.

2 FONCTIONNEMENT

LEVAGE

- Abaisser le cintre de levage à l'aide de la télécommande.
- Accrocher correctement les sangles du harnais.
- Lever le patient de manière douce et contrôlée.

TRANSFERT

- Déplacer le patient en toute sécurité.
- Ne pas tirer sur la télécommande pour déplacer le lève-personne.
- Maintenir une position stable pendant le déplacement.
  Commandes : ▲ Montée ▼ Descente

3 CHARGE DE LA BATTERIE

- Placer la télécommande du lève-personne sur son support mural de charge.
- Vérifier que la charge est en cours (voyant orange allumé sur le chargeur).
- Éviter la décharge complète de la batterie.



4 MAINTENANCE ET NETTOYAGE

- Utiliser des produits non abrasifs.
- Ne pas mouiller le lève-personne. Nettoyer avec un chiffon humide.
- Maintenance périodique.
- Inspection visuelle quotidienne.
- Contrôle technique annuel obligatoire.
- Remplacer les éléments usés uniquement par un service agréé.

5 RÉSOLUTION RAPIDE DES PROBLÈMES

PROBLÈME	ACTION
Ne fonctionne pas	Vérifier la batterie et l'arrêt d'urgence
Avertissement batterie faible	Mettre en charge
Mouvement irrégulier	Arrêter l'utilisation et prévenir la maintenance
Ne descend pas	Utiliser la descente d'urgence

Avertissements

- Lire intégralement ces instructions avant d'utiliser l'équipement.
- Ne pas dépasser la charge maximale indiquée.
- Ne pas utiliser le lève-personne si la sangle présente des dommages.
- Utiliser uniquement des harnais adaptés et homologués.
- Une batterie complètement déchargée peut provoquer des dommages permanents.

En cas d'urgence

Utiliser uniquement en cas de défaillance du système principal.

1 DESCENTE D'URGENCE

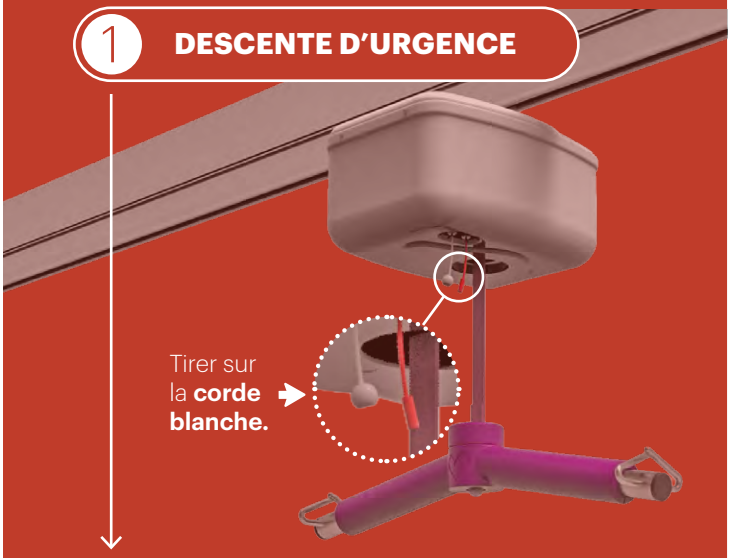

2 ARRÊT D'URGENCE

Tirer sur la **corde rouge.**

FORMATION RAPIDE

Scannez ici

Carima
Des solutions qui facilitent le mouvement

Tél. +34 943 06 20 16
service@carimatech.com
carimatech.com/fr